



MVCRP00VGZQX

MINISTERSTVO VNITRA

generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky
Kloknerova 26, pošt. příhr.69, 148 01 Praha 414

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK – veřejná zakázka malého rozsahu	
Číslo zakázky	MV-99599-2/IOO-2013
Název zakázky	Dodávka vybavení radiologické laboratoře pro úpravu vzorků
Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce)	Vybavení radiologické laboratoře pro úpravu vzorků
Datum vyhlášení zakázky	03.09.2013
Název zadavatele	Česká republika – Ministerstvo vnitra generální ředitelství HZS ČR, Institut ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč
Sídlo zadavatele	Na Lužci 204, 533 41 Lázně Bohdaneč
Jméno, případně jména, a příjmení osoby oprávněné jednat jménem zadavatele, její telefon a e-mailová adresa	plk. Ing. Mgr. Rostislav Richter 950580220 richter@ioolb.izscr.cz
IČO zadavatele	00007064
DIČ zadavatele	CZ00007064
Jméno, případně jména, a příjmení kontaktní osoby zadavatele ve věci zakázky, její telefon a e-mailová adresa	pplk. Ing. René Marek 950580331 Rene.Marek@ioolb.izscr.cz
Lhůta pro podávání nabídek	16.09.2013 - 10,00 hod
Místo pro podávání nabídek	Institut ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč Na Lužci 204, 533 41 Lázně Bohdaneč
Popis předmětu zakázky	Vybavení radiologické laboratoře pro úpravu vzorků
Předpokládaná hodnota zakázky v Kč (bez DPH)	528.000,-
Lhůta dodání / časový harmonogram plnění / doba trvání zakázky	29. listopadu 2013
Místo dodání / převzetí plnění	Institut ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč Na Lužci 204, 533 41 Lázně Bohdaneč
Hodnotící kritéria	· Nejnižší nabídková cena
Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele	· Kopie výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán · Kopie dokladu o oprávnění k podnikání

Požadavek na uvedení kontaktní osoby uchazeče	Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.
Požadavek na písemnou formu nabídky	Nabídka musí být zadavateli podána v písemné formě. Požadavek na písemnou formu je považován za splněný tehdy, pokud je nabídka podepsána osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče. Nabídka se dodává písemně a v uzavřené obálce označené názvem Veřejná zakázka „Dodávka vybavení radiologické laboratoře pro úpravu vzorků“ – NEOTEVÍRAT, na které musí být uvedena adresa.
Požadovaný jazyk nabídky	Jazyk český
Další požadavky na zpracování nabídky	Podáním nabídky dodavatel bere na vědomí, že zadavatel poté, co bude uzavřena smlouva s dodavatelem, který podal nejvhodnější nabídku, nebo poté, co bude výběrové řízení zrušeno, zveřejní na profilu zadavatele zprávu o posouzení a hodnocení nabídek, jejíž součástí budou mimo jiné i identifikační údaje všech dodavatelů, kteří podali nabídku a informace o nabídkových cenách těchto uchazečů a vyslovuje s výše uvedeným souhlas.
Zadávací řízení se řídí	<i>§ 6 a § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, přičemž na zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.</i>
Přílohy	<i>Příloha č. 1: Podrobná specifikace (8 listů) Prohlídka laboratoří pro zájemce o zakázku dne 09.09. 2013 v 10⁰⁰ hod.</i>
Podpis zadavatele	

Příloha č. 1 k č.j.: MV-99599-2/IOO-2013

Výtisk číslo: 1

Počet listů: 8

Technická specifikace - laboratorní nábytek

Nerezový a kovový nábytek

Nerezový a kovový nábytek se požaduje vyrobit z ocelových plechů o minimální síle 1,5 mm. Povrchová úprava kovového nábytku se požaduje nanesením epoxidového vypalovacího laku. Nerezový nábytek se požaduje z plechu (nerez 1.4301), který splňuje veškeré hygienické a konstrukční nároky kladené na tento nábytek. Nerez musí být chemicky odolný.

Konstrukce stolů a regálů se požaduje z nosného rámu z uzavřených čtvercových nebo obdélníkových dutých profilů spojených svařováním, doplněných plechovými deskami a policemi.

Konstrukce skříní musí být vyrobeny jako samonosné z plechu spojované svařováním případně nýtováním. Pro otvírání zásuvek ve skříních se použijí kuličkové nebo jiné výsuvy. Nábytek bude opatřen vhodnými rektifikačními nožičkami nebo kolečky.

Nábytek z lamina

Laboratorní nábytek z lamina se požaduje dodat z oboustranně laminované dřevotřískové desky o tloušťce 18 mm (nejlépe Egger, Kronospan).

Korpus skříní se požaduje ohraničit ABS hranou (např. HRANIPEX) o tloušťce 1 mm v barvě korpusu nebo v kontrastní barvě. Zásuva skříní vyrobit z jednostranně lakované MDF desky (Medium Density Fibreboard – středně zhuštěná dřevovláknitá deska) o min. tloušťce 3 mm. Zásava pojízdných kontejnerů se požaduje vyrobit z laminované dřevotřískové desky o min. tloušťce 18 mm. Dvířka a čela zásuvek skříní se požaduje ohraničit ABS hranou (např. HRANIPEX) o min. tloušťce 2 mm v barvě korpusu nebo v kontrastní barvě a opatřit tlumící dorazovou čoučkou např. HÄFELE. Zásuvky jsou požadovány s rolničkovým polovýsuvným pojezdem např. HETTICH. Police jsou požadovány s ocelovou čipkovou podpěrrou zabraňující vysunutí police. Skříňky jsou požadovány na výškově stavitelných nožkách. Kontejnery se požadují s otočnými bantamovými kolečky (přední musí být brzděné).

Pracovní povrchy

Postforming (tloušťka min. 35 mm) s přední zaoblenou hranou.

Epoxidová pryskyřice - DURCON - pracovní plocha se zvýšeným okrajem, bezespárý chemicky odolný materiál o síle min. 19mm, neporézní nenasákavý - absorpce vody max. 0,0076%. Pracovní deska musí být dekontaminovatelná po práci s roztoky radionuklidů v laboratoři klasifikované jako „Pracoviště kategorie I“, kde se vykonávají radiační činnosti dle přílohy č. 4 vyhlášky Státního úřadu pro jadernou bezpečnost č. 307/2002 Sb. o radiační ochraně. Klasifikace odolnosti vůči ohni - samozhášivý materiál.

Nerezová pracovní deska musí být složena z pevného nosného jádra a lesklého nerezového plechu (nerez AISI 316) síly 0,8 až 1 mm. Nerezový plech musí být na nosném jádru ohraněn a na spodní straně desky uzavřen do tvaru „L“. Nerez musí být chemicky odolný.

Normy, směrnice a předpisy

Laboratorní nábytek musí být vyroben v souladu s normou zdravotní nezávadnosti ČSN EN 717-1:2005 a kvality (mechanicko-fyzikální zkoušky) ČSN EN 14727, ČSN EN 13150, ČSN EN 527-1,2,3 ČSN EN 14074, ČSN EN 14073-3, ČSN 91 0001 a ČSN 91 0100.

Barevné provedení:

Výrobce musí navrhnout minimálně 5 barevných provedení. Volba barevného provedení jednotlivých sestav bude upřesněna objednatelem po podání nabídek.

Montáž a instalace:

Nábytek se požaduje dodat s montáží a instalací vody, odpadů, elektroinstalací zásuvek, napojením na stávající odtahy, rozvodem plynu propan – butan (včetně dodání 10kg lahve s redukčním ventilem – láhev je nutno pevně fixovat do dodané skříně) a instalací plynu na 3 mediové sloupky.

Specifika Ra pracovních povrchů:

Použité pracovní povrchy (DURCON, nerez) musí splňovat příslušné předpisy a normy pro práci s otevřenými a uzavřenými zářiči a být dekontaminovatelné pro práci s roztoky radionuklidů v laboratoři klasifikované jako „Pracoviště kategorie I“, kde se vykonávají radiační činnosti dle přílohy č. 4 vyhlášky Státního úřadu pro jadernou bezpečnost č.307/2002 Sb. o radiační ochraně.

B - RADIOMETRICKÁ LABORATOŘ 417 - DRTIČKA

B1 - Dílenský stůl 1800x550x850mm (1ks) - Dílenský stůl z montované kovové konstrukce vybavený kontejnerem 810x500x700mm se třemi zásuvkami a skříňkou 810x500x700mm s dvířky. Zásuvky o celkové nosnosti 80 kg s kvalitními teleskopickými výsuvy, výška zásuvek 1x 180mm, 2x 240mm, Vnitřní dělení horní zásuvky z pozinkovaného plechu 4 x 3, pro zásuvky 150 –240mm. Nosnost konstrukce stolu 300 kg s výškově stavitelnými nožkami. Pracovní plocha z kvalitní bukové spárovky tl. 40 mm, hloubka 550mm, horní hrany pracovní desky zaobleny (r=3mm). Na pracovním stole se požaduje protiúnavová rohož vyrobená z přírodní pryže s podílem nitrilu. Odolná vůči olejům a tukům se slzičkovým povrchem bránícím uklouznutí se zkosenými hranami o šířce 550mm.

B2 - Skříň kovová vysoká otevřená 1200x400x1950mm s plastovými boxy (1ks) – Pevná skříň, otevřená, 9x pevná police (nosnost každé police 60 kg), výška 5 prostorů mezi policemi po 153mm (horní část skříně) a zbývajících 5 prostorů po 193mm (dolní část skříně). Plastové boxy pro horní část skříně jsou - o objemu 4,4l, nosnost 5kg, rozměry 150x235x125mm (35ks) a plastové boxy pro dolní část skříně jsou - o objemu 10l, nosnost 8kg, rozměry 207x345x165mm (25ks)

B3 – Skříň kovová vysoká otevřená 400x400x1950mm s plastovými boxy (1ks) – Pevná skříň, otevřená, 6x pevná police (nosnost každé police 35kg), výška prostoru mezi policemi je stejná. Do každého prostoru se požaduje dodat plastový box o rozměrech 400x300x220mm a nosnosti 25kg (celkem 7ks)

B4 - Stůl 1050x600x850mm: Konstrukce stolu - svařovaná "A", tenkostěnný kovový profil povrchová úprava kovových částí – komaxit, pracovní povrch postforming, tloušťka 38mm, nosnost do 100kg. A výškově stavitelné nožky. Pod stolem se nachází jedno dveřová skříň (levé dveře, 2x stavitelná police) a řadou pěti šuplíků (umístění vlevo)

B5 - Laboratorní mycí stůl NEREZ 1700x600x900mm: Nerezová svařovaná konstrukce typu "A" s nerezovou deskou s odkapávačem (voda z odkapávače musí samovolně stékat do odpadu), 1x nerezový dřez (umístěný uprostřed stolu a odkapávač vlevo od dřezu), 1x stojánková dřezová baterie s vytahovací sprškou. Pod dřezem je spodní skříňka NEREZ 600x600x790 - 1x dvířka levá, 1x stavitelná police s výřezem pro armaturu odpadu. Nerez musí být chemicky odolný.

E - RADIOMETRICKÁ LABORATOŘ 420 - Úprava vzorků

E1 – Skříňka (1ks) skládá se:

- **Horní skříňka na pracovní desce 800x400x1200mm (1ks)** - lamino 3x police stavitelná, 1x žaluzie
- **Pracovní deska 1200x750x38mm (1ks)** – pracovní plocha - postforming tl. 38mm
- **Spodní skříňka 1200x620x900mm (1ks)** – 12cm odskok od stěny (2x zásuvky pod pracovní deskou, 2x dvířka, 1x výškově stavitelná police), skříň přišroubovaná na soklu

E2 – LTD ochranná deska nad mycím stolem 2100x18x1200 mm (1ks) - ohraněna hranou tl. 2mm barvě materiálu, výřezy na dvě elektro zásuvky, na desce připevněn laboratorního skla

E3-1 - Mycí stůl nerezový pravý 2100x750x900mm (1ks) – Nerezová svařovaná konstrukce tenkostěnných nerezových profilů s nerezovou deskou s odkapávačem (umístěný vlevo od dřezu) vyspádovaným s odtokem do odpadu, 2x nerezový dřez, 2x stojánková dřezová baterií s vytahovací sprškou. Nerez musí být chemicky odolný.

E3-2 spodní skříňka (vlevo) NEREZ 600x500x790mm (1x) - (1x dvířka, 1x stavitelná police). Nerez musí být chemicky odolný.

E4 - Laboratorní stůl se spodními skříňkami 1200x750x760mm (2x) - svařovaná "H", tenkostěnný kovový profil povrchová úprava kovových částí – komaxit, výškově stavitelné nožky

Pracovní deska 1200x750x38mm (1ks) - povrch postforming, tloušťka 38mm,

Spodní skříňka dvířková 560x520x680mm (1ks) - 1x dvířka, 1x stavitelná police, skříň přišroubovaná na soklu

Spodní skříňka zásuvková 560x520x680mm (1ks) - 4x zásuvka, skříň přišroubovaná na soklu

E5 - Laboratorní stůl se spodními skříňkami a digestoři pro odtah 1200x750x760mm (1x) - svařovaná "H", tenkostěnný kovový profil povrchová úprava kovových částí – komaxit, výškově stavitelné nožky

Pracovní deska 1200x750 (1ks) - nerezová deska,

Spodní skříňka dvířková 560x520x680mm (1ks) - 1x dvířka, 1x stavitelná police, skříň přišroubovaná na soklu

Spodní skříňka zásuvková 560x520x680mm (1ks) - 4x zásuvka, skříň přišroubovaná na soklu

Médiový sloupek lamino 250x150x400 - 1x sloupek, 2x vývod plynu (přívody na P-B Kahan a plynový vaříč), 1x větrací mřížka

Digestoř pro odtah 1200x750mm (1ks) – nerezová digestoř nad pracovním stolem, požaduje se napojení na stávající odtah

E6 – Kovová skříň (1ks) - rozměr (š x h x v): min. 460 x 400 x 750 mm. 1x dveře se zámkem. Vnitřní prostor větratelný a napojení na stávající vzduchotechniku.

E7 - Skříň vysoká s žaluzií 1000x400x2100mm (1ks) - lamino 4x police stavitelná, 1x police pevná, 2x žaluzie, skříň přišroubovaná na soklu

E8 – Laboratorní židle (2ks) – otočná se zádivou opěrkou, chrom, omyvatelné čalounění, kruhová podnož, výškově stavitelná do 600mm

F - RADIOMETRICKÁ LABORATOŘ Č.420.2 (ZADNÍ ČÁST)

F1 - Sestava jednostranný laboratorní stůl 2400x750/300x900/1550mm přišroubovaný na soklu:

F1 - 1 - Pracovní deska 2400x750x30mm (1ks) - DURCON (epoxid), zvýšený okraj

F1 - 2 - Epoxidová výlevka se stojánkovou baterií - umístěna v desce vpravo s odkapávačem (odkapávač umístěný vpravo od výlevky), výlevka o vnitřním průměru 406 x 406 x 191 mm, výlevku umístit 100-120mm od přední hrany desky, 1x stojánková dřezová baterie s vytahovací sprškou.

F1 - 3 - Spodní laboratorní skříňky (1ks) -

Laboratorní skříňka spodní dvířková pod dřezem 600x520x870mm (1ks) - 1x dvířka levá, 1x stavitelná police, skříň přišroubovaná na soklu

Laboratorní skříňka spodní zásuvková 600x520x870mm (1ks)- 5x zásuvka, skříň přišroubovaná na soklu

Laboratorní skříňka spodní zásuvková - dvířková 600x520x870mm (1ks) - 1x dvířka levá, 1x zásuvka pod pracovní plochou a 1x stavitelná police, skříň přišroubovaná na soklu

Laboratorní skříňka spodní zásuvková - dvířková 600x520x870mm (1ks) - 1x dvířka pravá, 1x zásuvka pod pracovní plochou a 1x stavitelná police, skříň přišroubovaná na soklu

F1 - 4 - Médiová stěna lamino 1200 x 175 x 625mm (1ks) – umístěná na pracovní desce vpravo, **1x horní pracovní deska 1200x300x25mm**, 2x sloupek, 1x police mezi sloupky, ve sloupcích je zaveden 1x plyn, 4x elektro zásuvky 230V/IP44, 1x studená voda

F1 - 5 - LTD ochranná deska 2400x18x900 mm (1ks) - ohraněna hranou tl. 2mm barvě materiálu, **LTD ochranná deska 750x18x900 mm (1ks)** - ohraněna hranou tl. 2mm barvě materiálu; LTD desky k sobě navzájem zatmelené

F2 – Laboratorní židle (1ks) – otočná se zádovou opěrkou, chrom, omyvatelné čalounění, kruhová podnož, výškově stavitelná do 600mm

F3 - Skříň vysoká s žaluzií 500x420x2100mm (2ks) - lamino 4x police stavitelná, 1x police pevná, 2x žaluzie, skříň přišroubovaná na soklu


F4- Váhový stůl 1200x750x760mm (1ks) – 1x váhovým kamen

F5 – Sestava nástěnná skříňka (1ks):


Nástěnná skříňka 600 x 320 x 650 mm (1ks): 1x dvířka pravá, sklo v rámu, 1 stavitelná police

Nástěnná skříňka 600 x 320 x 650 mm (1ks): 1 x dvířka levá, sklo v rámu, 1 stavitelná police

F6 - Stropní závěsná police (1ks) – jde o závěsnou polici upevněnou na stropu pro dataprojektor, o vnitřních rozměrech 350x400x25mm (vnitřní zvýšený okraj), od dna police do stropu je vzdálenost 1060mm . V dodávce se požaduje přišroubování police ke stropu a vedení signálového kabelu RBG o délce 12m a síťové napájecí šnůry o délce 10m. Dále se požaduje instalace kabelů do lišt o délce 8m.

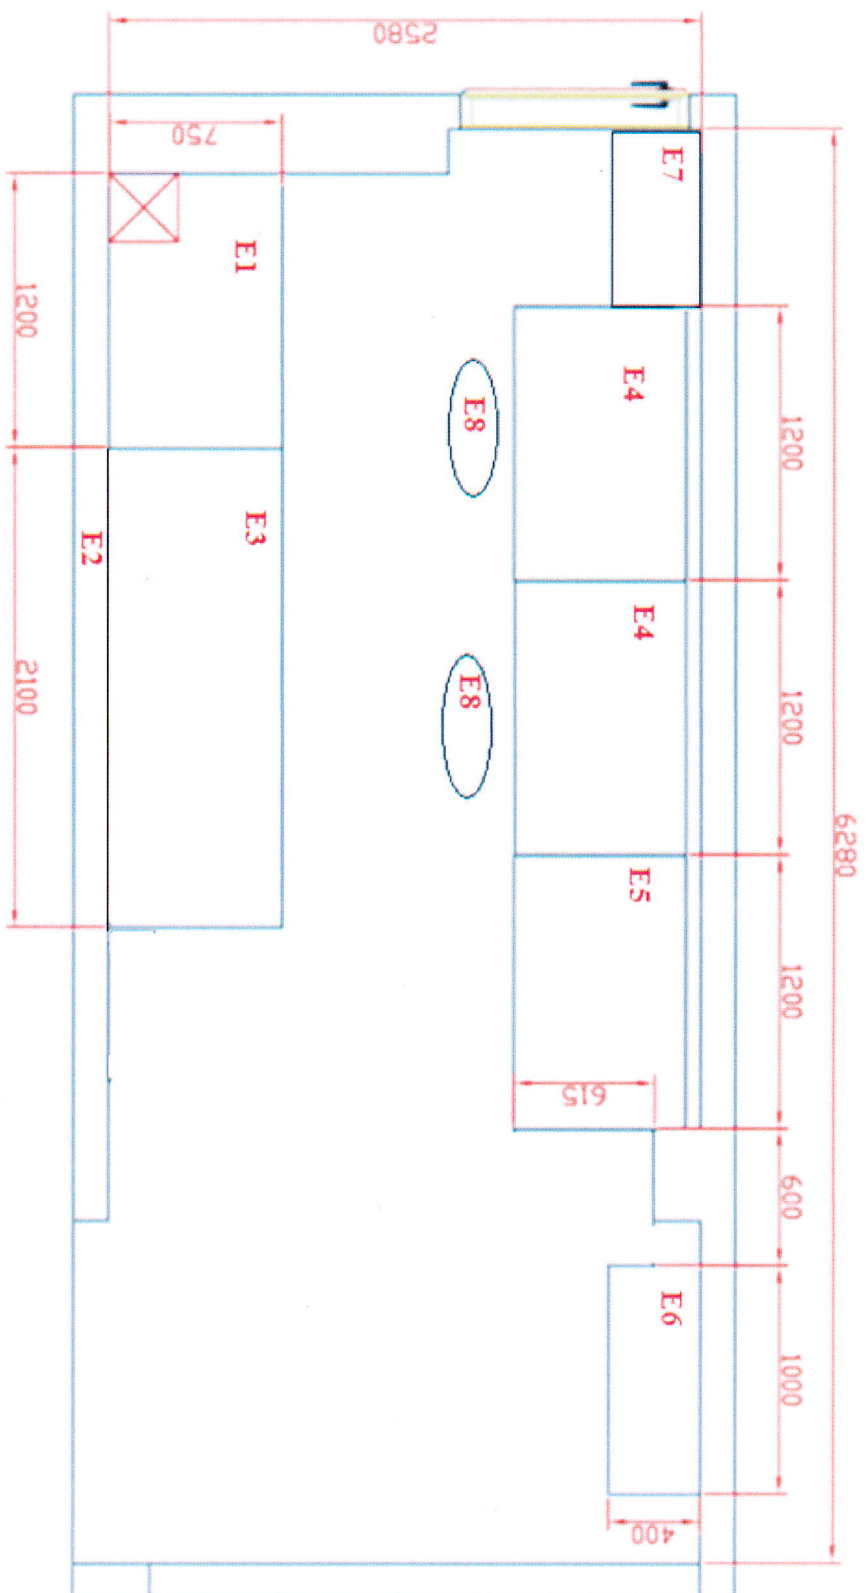

Mistmost 420.1

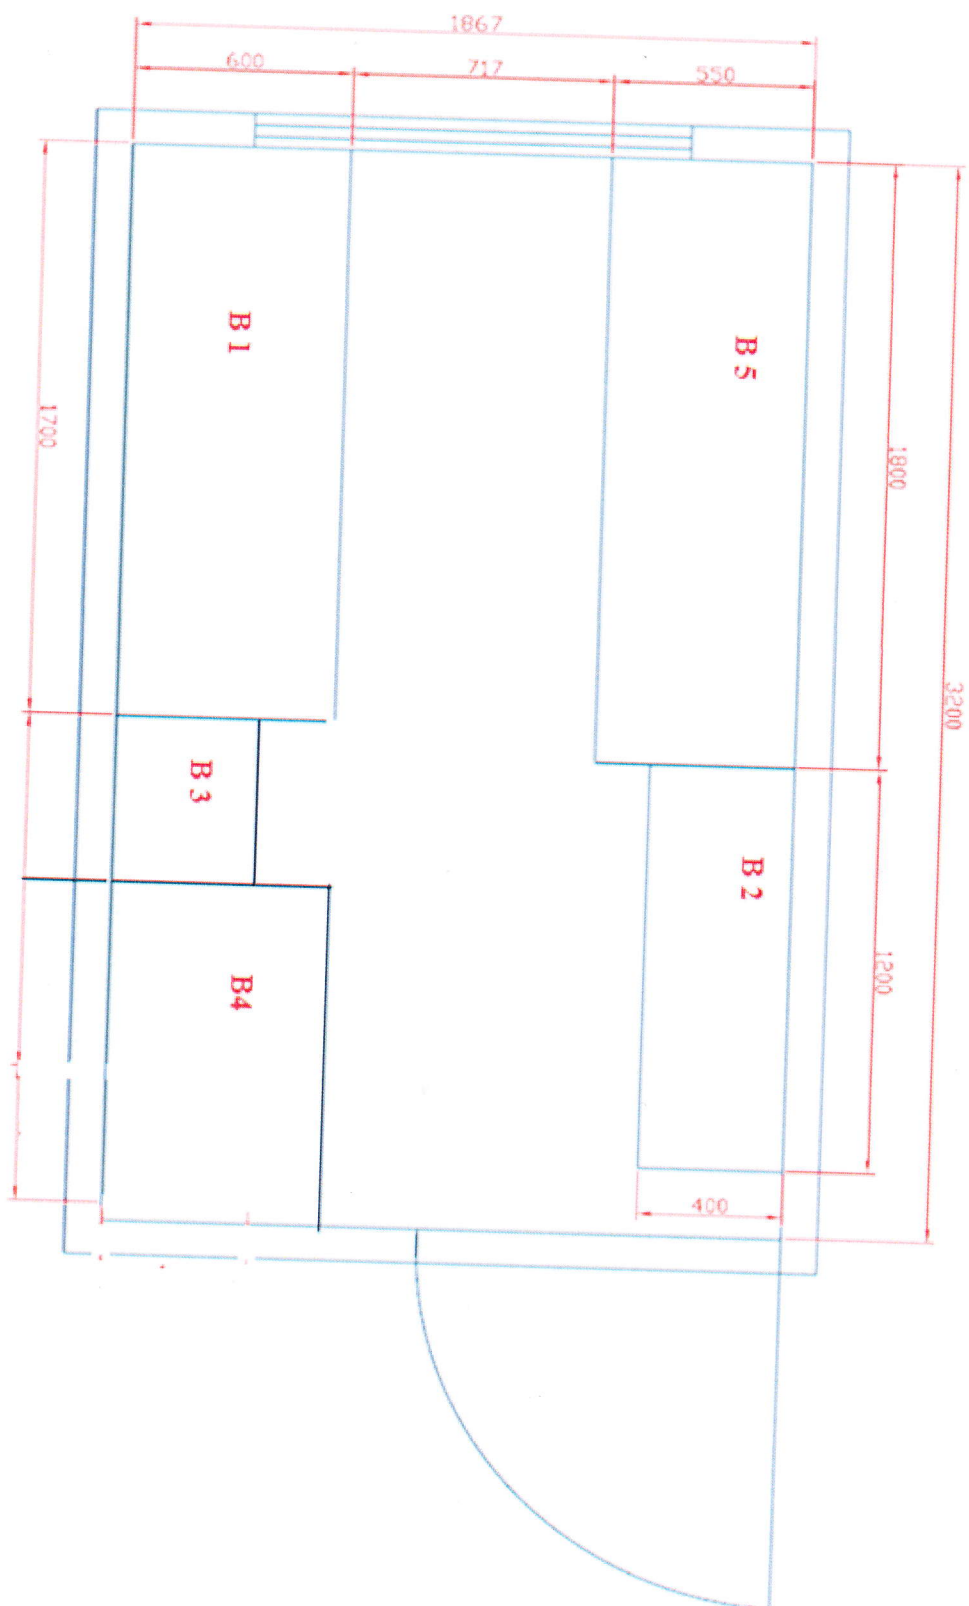

misnost 417

